



中华人民共和国工业和信息化部 机械计量技术规范

JJF（机械） xxxx—2023

SPD 动作负载测试装置校准规范

（送审稿）

Calibration specification of direct current measurement system

2023-XX-XX 发布

2023-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

SPD 动作负载测试装置 校准规范

Calibration specification of
direct current measurement system

JJF（机械）XXXX—2023

归口单位：中国机械工业联合会

主要起草单位：甘肃电器科学研究院

参与起草单位：甘肃省天水市计量测试检定所

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

燕 琦：[甘肃电器科学研究院]

孙文宝：[甘肃电器科学研究院]

龙作亮：[甘肃电器科学研究院]

参加起草人：

刘永杰：[甘肃省天水市计量测试检定所]

韩 兴：[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）]

任雪玲：[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）]

袁 博：[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）]

目录

引言..... II

1 范围..... 1

2 引用文件..... 1

3 术语和计量单位..... 1

4 概述..... 2

5 计量特性..... 2

6 校准条件..... 3

7 校准项目和校准方法..... 3

8 校准结果表达..... 7

9 复校时间间隔..... 7

附录 A SPD 动作负载测试装置示值误差测量不确定度评定示例..... 8

附录 B 校准原始记录格式 15

附录 C 校准证书内页格式..... 17

引言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。本规范主要用于 SPD 电涌保护器动作负载测试装置的校准。

本规范为新制订。

SPD 动作负载测试装置校准规范

1 范围

本规范适用于 SPD 电涌保护器动作负载测试装置的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059-2012 《测量不确定度评定与表示》

GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD）第 1 部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》

JJF（机械）109-2014《冲击电流测量系统校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范

3.1 电涌保护器（SPD） surge protective device

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的电器，它至少包含一非线性的元件。

3.2 最大持续运行电压 maximum continuous operating voltage (U_c)：

可持续加于电子系统电涌保护器端子上，且不致引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。

3.3 标称放电电流 nominal discharge current

I_n 流过电涌保护器 SPD 具有 8/20 波形的电流峰值。

3.4 冲击电流 impulse current

I_{imp} 由三个参数来定义：电流峰值 I_{peak} 、电荷量 Q 和比能量 W/R 。一般用于 SPD 的 I 级分类动作负载试验参数。

3.5 最大放电电流 (I_{max})

一般情况下等于 2 倍 I_n 。一般用于 SPD 的 II 级分类动作负载试验参数，其值按 II 类动作负载试验的程序确定。 I_{max} 应大于 I_n 。

3.6 I 级试验（class I test）

电气系统中采用Ⅰ级试验的电涌保护器要用标称放电电流 I_n 、1.2/50 μ s 冲击电压和最大冲击电流 I_{imp} 做试验。

3.7 Ⅱ级试验 (class II test)

电气系统中采用Ⅱ级试验的电涌保护器要用标称放电电流 I_n 、1.2/50 μ s 冲击电压和 8/20 μ s 电流波最大放电电流 I_{max} 做试验。

3.8 续流 follow current

I_f 冲击放电电流以后, 由电源系统流入电涌保护器 SPD 的电流。

3.8 额定负载电流 rated load current

I_L 能提供给连接到电涌保护器 SPD 保护输出端的负载的最大持续额定交流电流有效值或直流电流。

3.9 限制电压 measured limiting voltage

施加规定波形和幅值的冲击时, 在电涌保护器 SPD 接线端子间测得的最大电压峰值。

3.10 暂时过电压试验值 temporary overvoltage test value

U_T 施加在电涌保护器 SPD 上并持续一个规定时间的试验电压, 以模拟在 TOV 条件下的应力。

3.11 残压 residual voltage

放电电流流过电涌保护器 SPD 时, 在其端子间产生的电压峰值。

4 概述

电涌保护器适用于 220/380V 低压电源保护, 是一种非线性元件, 根据国标规定, 电涌保护器是主要抑制传导过来的线路过电压和过电流的装置。电涌保护器起到保护作用, 基本要求是必须承受预期通过的雷电电流, 并且通过电涌最大钳压, 有效熄灭在雷电电流通过后产生的工频续流, 把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内, 或将强大的雷电流泄流入地, 保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。标准规定凡在低压配电系统中使用的 SPD 必须通过动作负载试验, 以保障 SPD 在线路中运行时遭遇雷击不仅能短时间内泄放雷电流, 而且能有效的截断工频电源的注入 (切断续流), 因此对电涌保护器 SPD 的参数校准极为重要。

5 计量特性

主要计量特性: 最大持续工作电压: (0.1~3000) V, 最大允许误差: $\pm 3\%$

冲击电流：（0.1~250）kA，最大允许误差：±10%

续流电流：（0.1~1.5）kA，最大允许误差：±5%

施加冲击电流时与工作电压的相位：（0.1°~360°），

最大允许误差：±1°

残压：（0.1~20）kV

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（20±10）℃

6.1.2 湿度：≤80%RH

6.1.3 电源要求：220（1±10%）V

6.1.4 电源频率：（50±0.5）Hz

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 标准冲击电流传感器：电流（0.1~300）kA，最大允许误差：±1%

标准工频电流传感器：（0.1~2000）A，最大允许误差：±0.5%

差分探头：（0.1~7）kV，最大允许误差：±0.2%

或交直流分压器：（0.1~7）kV，最大允许误差：±0.2%

数字示波器：带宽：500MHz，最大允许误差：±1%

数字多用表：（0.01~1000）V，最大允许误差：±0.1%

残压分压器：（0.1~20）kV，最大允许误差：0.2%

6.2.2 原则上标准不确定度小于被校测量允许误差的 1/3。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表 1。

表 1 校准项目

序号	项目名称	校准方法条款
1	最大持续工作电压校准	7.2.2
2	冲击电流校准	7.2.3
3	续流电流校准	7.2.4
4	相位校准	7.2.5
5	残压校准	7.2.6

7.2 校准方法

7.2.1 外观及性能检查

被校准 SPD 动作负载测试装置应外观完好，各组成部分应功能正常、各开关和按钮灵活可靠，名称、生产厂家、型号、编号信息等标识清晰。

在校准之前应该对被校SPD动作负载测试装置按照说明书进行预热，开机后被检仪器应能正常工作，各种显示正确，各开关及功能键显示正常，量程切换正常，基本功能能正常工作。

7.2.2 最大持续工作电压校准

校准连接线及校准点的选取：

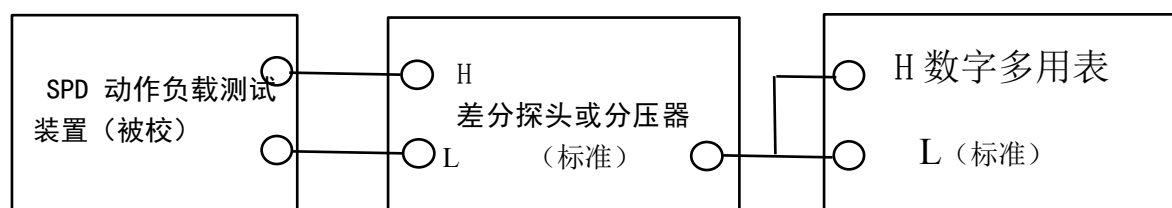


图1 校准接线示意图

如图 1 所示的直接比较法进行校准。按照量程均匀选取 3~5 个校准点，或者根据客户需求自行选择校准点，同时用标准差分探头与数字多用表组成的测量系统和被校准 SPD 动作负载测试装置测量同一电压，两个测量系统同时读数，标准测量系统测出实际高压值 U_s ，被校准测量系统测出高压值 U_x ，利用公式（1）计算出被校测量系统的基本误差。

SPD 动作负载测试装置最大持续电压基本误差表达式为公式（1）。

$$r_U = \frac{U_x - U_s}{U_s} \times 100\% \quad \dots\dots (1)$$

式中： r_U ——被校 SPD 动作负载测试装置基本误差；

U_s —— 标准测量系统电压值；

U_x —— 被校 SPD 动作负载测试装置电压值。

7.2.3 冲击电流校准

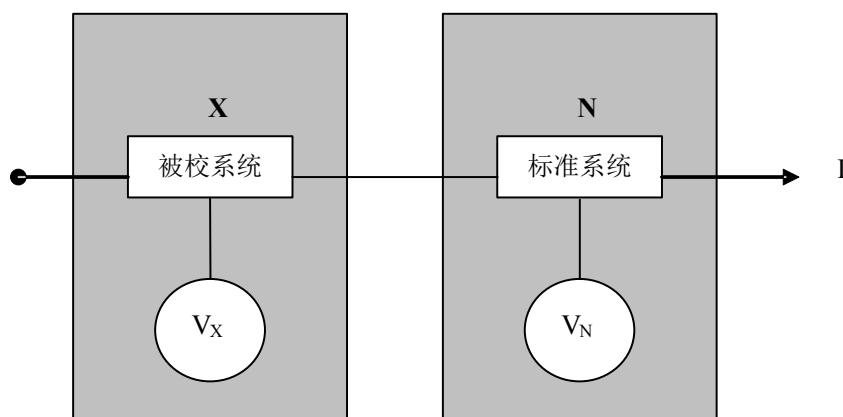


图2 校准接线示意图

整SPD动作负载测试装置的刻度因数是通过与标准测量系统的比对确定的。标准测量系统与被校测量系统串联连接，连接方式如图2所示。应采取措施避免电流传感器和测量仪器间的接地环路造成不可接受的影响。

两个系统应同时读数。由标准测量系统读到的每次测量的一次电流峰值除以被校电流传感器的相应的二次读数求得在电流水平 I 下测量的刻度因数 $F_{i,g}$ 值。重复该测量 n 次，求取被校电流传感器在某一电流水平 I_g 下的刻度因数的算术平均值 $\overline{F_g}$ 。平均值由公式（2）给出：

$$\overline{F_g} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{i,g} \quad \dots\dots (2)$$

7.2.4 续流电流校准

将工频电流传感器串联接入工频续流电流回路中如图3，此回路应连接到工频电源，按照客户需求在量程范围内均匀选择5~8个校准点，500A为必校准点，在示波器中采集对应的波形，通过测量计算得到实际电流值 I_{xf} ，同时读取SPD动作负载测试装置续流读数 I_{sf} ，以此计算出被校SPD动作负载测试装置和实际电流值之间的误差，SPD动作负载测试装置最大持续电压基本误差表达式为公式（3）。

$$r_{ff} = \frac{I_{xf} - I_{sf}}{I_{sf}} \times 100\% \quad \dots\dots (3)$$

式中： r_{ff} ——被校SPD动作负载测试装置续流相对误差；

I_{sf} ——标准系统电流读数值；

I_{xf} ——被校 SPD 动作负载测试装置续流读数值。

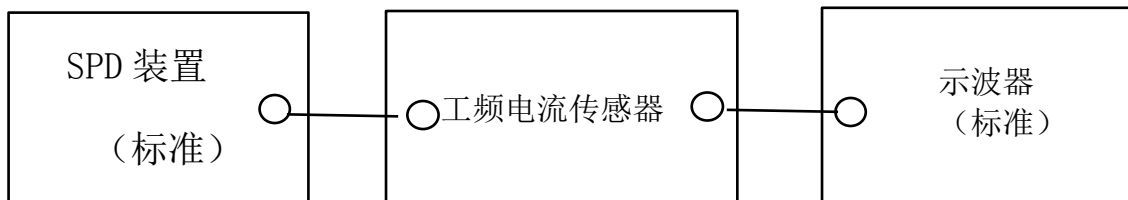


图3 校准示意图

7.2.5 相位校准

施加 15 次 8/20 正极性的冲击电流，分成 4 组，每组 3 次冲击。样品与符合要求的工频电源连接。每次冲击应与电源频率同步。从 0° 角开始，同步角应以 $30^\circ \pm 5^\circ$ 的间隔逐级增加。我们需要校准电角度的数值是否满足要求。波形记录仪中采集对应的波形，通过测量得到电角度值，电流波实际起始角度计算公式（4）。

$$T = (\Delta t - 20ms) / 20ms \times 360^\circ \dots\dots (4)$$

7.2.6 残压校准

采用如图 4 所示的直接比较法进行校准。即同时用标准测量系统和被校准测量系统测量所示试品两端的电压，两个测量系统同时读数，标准测量系统测出实际高压值 U_s ，被校准测量系统测出高压值 U_x ，利用公式（5）计算出被校测量系统的基本误差。

$$r_U = \frac{U_x - U_s}{U_s} \times 100\% \dots\dots (5)$$

式中 r_U ——被校 SPD 动作负载测试装置残压基本误差；

U_s —— 标准测量系统冲击电压值；

U_x —— 被校 SPD 动作负载测试装置残压值。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988020075051006116>